

QUIENES SOMOS LOS RESPONSABLES:



INVIMA: Controlando la llegada de reactivos in vitro, su almacenamiento y distribución por las comercializadoras. Emitiendo las alarmas respectivas que se generan tanto nacional como internacionalmente.

CLÍNICA LAS LAJAS: Seleccionando las comercializadoras, verificando que cada reactivo tenga su código INVIMA vigente, Atendiendo a las Alarmas, e Informando a los reguladores y verificadores de ser necesario.



PACIENTE: Si los resultados según su médico salen no confiables presentar quejas o reclamos.



CONSECUENCIAS PARA EL COLABORADOR:
Ninguna... Al contrario su aporte con el reporte permite que gane la Clínica las Lajas y Ganemos todos.



SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN



PROGRAMA REACTIVO VIGILANCIA

PLAN PADRINO
Cartilla 23
ABRIL/2018

REACTIVO VIGILANCIA

Busca eventos adversos e incidentes que se pueden causar por la utilización de los Reactivos de Diagnostico Invitro que se usan para estudiar sus muestras.
De presentarse se informa así:


**EVENTO ADVERSO
(INMEDIATO)**
EJ. MUERTE PACIENTE




INVIMA



**INCIDENTES
(TRIMESTRALMENTE)**
EJ. REACTIVO ROTO,
T° NO ADECUADA,
ETIQUETA ILEGIBLE,
INTRUCTIVO
(INSERTO) EN OTRO
IDIOMA



**INSTITUTO
DEPARTAMENTAL
DE SALUD**

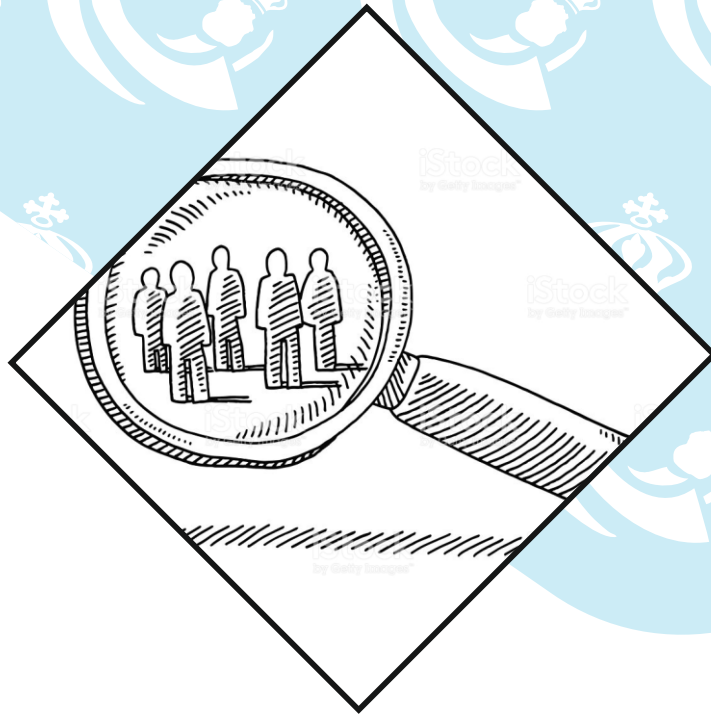

POR QUE SE REPORTA?

Los Reactivos se importan a Colombia desde Estados Unidos o Europa, por empresas comercializadoras (vigiladas por Invima) y estas la entregan al laboratorio de Clínica las lajas.



¡Es muy Complejo... Verdad ! Durante el viaje se pueden deteriorar (Requieren refrigeración), dañar (romper, contaminar, etc) o pueden adulterar (falsificar)

